FISSO ホルダーシステム(内視鏡・レトラクター等用)
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) 本来の使用目的以外に使用しないでください。
2) 本品を分解したり、二次的加工をしないでください。
3) 関節アームは浸漬しないでください。
4) 潤滑剤は使用しないでください。
5) 保持可能な重量（約４kg）を超えないようにしてください。
6) 関節アームは、電流、熱を患者に伝導するため、電源や熱の接触を避けるか必要に応じて絶縁レールクランプを使用してください。
7) 位置の変更を行う時、可動部位が周辺機器と衝突しないようにじゅうぶん注意してください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

ホルダー及び関節アーム（医療機器）、コラム及びレールクランプ（非医療機器）から構成されます。

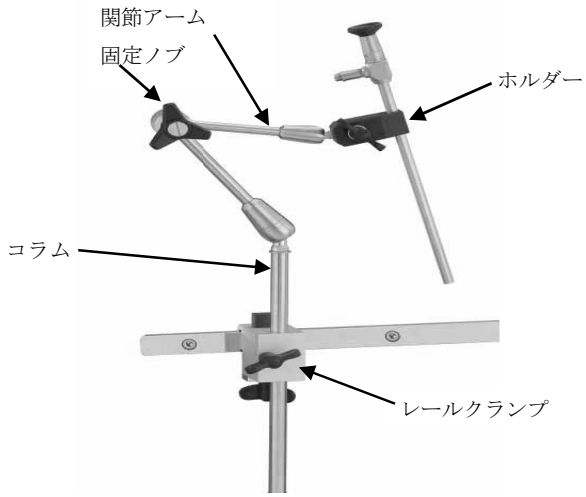

3. 組立・設置方法

1) 手術台等のレールにレールクランプを挿入しネジ式ハンドルによって固定します。
2) レールクランプにコラム（関節アーム付）を挿入し固定します。
3) 関節アームにホルダーを固定します。
4) ホルダーに内視鏡等を挿入し、固定します。

> ⚠ 注意
>
> 組立・設置に際し、工具は必要ありません。ネジ式ハンドル・固定ノブは必要最低限の力で締め付けてください。

4. 使用前の準備に関する事項

使用前に、可動範囲、関節アーム・内視鏡等の固定、レールクランプによる手術台等への固定が確実になされているか確認してください。

5. 一般的な使用方法とその注意事項

関節アームの固定ノブをゆるめて内視鏡等を目的とする位置に移動させ、調整し固定します。固定ノブをゆるめる際はアームの落下を防止するため、片手でホルダー部を保持しもう片方の手で固定ノブをゆるめてください。

6. 使用後の処理に関する事項

汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液、体液、組織、薬品等は使用後直ちに（2時間以内）洗浄除去し消毒してください。

7. 医療機器の清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
2) 滅菌した状態で保管する場合、滅菌有効期限を管理してください。

8. 保守点検に関する事項

1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液、体液、組織、薬品等は使用後直ちに（2時間以内）洗浄除去し消毒してください。
2) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤等、金属腐食の原因となる成分を含む薬剤の使用を避けてください。中性洗剤を推奨します。洗剤・消毒剤使用に際しては、それぞれメーカーの使用上の注意を遵守してください。
3) 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は器具表面を損傷するので使用を避けてください。柔らかいブラシや布を推奨します。
4) 仕上げすすぎには脱イオン水の使用を推奨します。
5) 洗浄後、腐食防止のために直ちに乾燥させてください。
6) 潤滑剤は使用しないでください。
7) 滅菌前に、汚れ・破損・可動部の動き等を点検してください。
8) 点検後、滅菌のための適切な包装を行ってください。その際、可動部分の開放等により、確実な滅菌ができるよう配慮してください。以下の滅菌条件を推奨します。

方法	温度	時間
高圧蒸気滅菌	121℃	20分
高圧蒸気滅菌	134℃	5分

9) その他の滅菌は有効性の確認が取れておりませんのでご遠慮ください。
10) 関節アームを滅菌する場合は、固定ノブを緩めた状態で行ってください。

9. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

【セット】

注文コード	セット名	セット内訳
737-001-10	内視鏡ﾎﾙﾀﾞｰｼｽﾃﾑｾｯﾄ	K26、G8、V5-1、S3-3
737-001-20	内視鏡ﾎﾙﾀﾞｰｼｽﾃﾑｾｯﾄ	K26、G8、V5-1、S7
737-001-30	内視鏡ﾎﾙﾀﾞｰｼｽﾃﾑｾｯﾄ	K26、G8、V5-1、S30
737-002-10	ﾚﾄﾗｸﾀｰﾎﾙﾀﾞｰｾｯﾄ	K30、G8、V60、S3-3
737-002-20	ﾚﾄﾗｸﾀｰﾎﾙﾀﾞｰｾｯﾄ	K30、G8、V60、S7

【部品・付属品】

注文コード	型番	品名
737-001-11	K30	レトラクターホルダー：0-18mm（フラットな器具）対応、φ4-18mm（丸みのある器具）対応
737-001-12	K26	内視鏡ホルダー、φ5/10mm 用
737-002-12	G8	関節アーム、可動半径 400mm
737-003-03	V5-1	コラムφ16x300mm
737-003-11	V60	Ｌ型コラム　φ16、450x100mm
737-003-07	A6	ストッパー蓋、φ20mm
737-004-02	S3-3	レールクランプ（8x35mm／ 10x25mm レール対応）
737-004-04	S7	ユニバーサルクランプ（φ10-40mm ポール、8x35mm／10x25mm レール対応）
737-004-07	S30	絶縁レールクランプ、（8x35mm／10x25mm レール対応）

10. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ) 本書の提示がない場合。
   (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ) 消耗部品。
   (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*FISS0 ホルダーシステム(内視鏡・レトラクター等用)*をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: *FISS0 ホルダーシステム (内視鏡・レトラクター等用)* 製造番号： ご芳名	お買い上げ店名 印
ご住所 TEL.　　(　　)	住所 TEL.　　(　　)
	お買い上げ日　　年　　月　　日

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546